

## VACUETTE® QUICKSHIELD Complete (avec gaine rotative) Mode d'emploi

### Utilisation prévue

**VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** est destiné à être utilisé uniquement avec les tubes de prélèvement sanguin **VACUETTE®** lors des prises de sang de routine. Ce dispositif est pourvu d'une gaine de sécurité destinée à recouvrir l'aiguille immédiatement après la prise de sang, pour prévenir les blessures accidentelles par piqûre d'aiguille. Il est à usage unique et doit être uniquement utilisé par des professionnels de santé correctement formés conformément aux présentes instructions.

### Description du produit

Le dispositif stérile **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** comporte un corps de pompe avec sécurité **VACUETTE® QUICKSHIELD** et une aiguille à prélèvement à usage multiple **VACUETTE®** préinstallée sous blister. Ce corps de pompe en plastique, à usage unique et stérile est équipé d'une gaine de sécurité qui peut être activée pour recouvrir l'aiguille immédiatement après la prise de sang.

### Précautions/Mises en garde

1. Ne pas utiliser le dispositif **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** s'il est endommagé.
2. Si l'emballage stérile est endommagé ou ouvert involontairement avant l'utilisation, le produit ne doit pas être utilisé et doit être éliminé.
3. Chaque dispositif **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** contaminé par du sang est considéré comme dangereux et doit être immédiatement éliminé.
4. Ne pas placer de capuchon sur l'aiguille.
5. Ne pas tordre l'aiguille.
6. Après la prise de sang, éliminer l'aiguille usagée et le **VACUETTE® QUICKSHIELD** sans les désassembler dans le conteneur prévu pour les objets tranchants, conformément aux protocoles et procédures en vigueur au sein de votre établissement.
7. Gardez toujours les mains à l'arrière de l'aiguille pendant son utilisation et son élimination.
8. Manipuler tous les échantillons biologiques et les instruments tranchants de prélèvement sanguin conformément aux protocoles et procédures en vigueur au sein de votre établissement.
9. Demander un avis médical approprié en cas d'exposition à des échantillons biologiques (par exemple, lors d'une blessure par piqûre d'aiguille) car ces échantillons peuvent transmettre le VIH, l'hépatite virale ou d'autres maladies infectieuses.
10. Jeter les instruments « tranchants » de prélèvement sanguin dans les conteneurs prévus à cet effet.
11. Porter en permanence des gants lors de la prise de sang pour réduire le risque d'exposition.

Applicable uniquement aux États membres de l'Union européenne : tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur/le patient est établi.

### Stockage avant utilisation

Stocker les corps de pompe à une température comprise entre 4 et 36 °C (40 et 97 °F).

**REMARQUE** : éviter toute exposition à la lumière directe du soleil. Le corps de pompe risque d'être endommagé s'il est stocké à une température supérieure à la température de stockage maximale recommandée.

### Manipulation

#### LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INFORMATIONS SUIVANTES AVANT UNE PRISE DE SANG.

PORTER DES GANTS PENDANT LA PRISE DE SANG ET LORS DE LA MANIPULATION DES TUBES DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN AFIN DE MINIMISER LES RISQUES D'EXPOSITION !


1. Ouvrir l'emballage blister et retirer entièrement le dispositif de son emballage.

**REMARQUE** : la présence de l'emballage blister indique que le produit est stérile et intact. Si l'emballage blister est déchiré ou endommagé, éliminer le **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** et en sélectionner un autre.

**REMARQUE** : ne pas tordre les aiguilles ni utiliser **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** lorsque l'aiguille est tordue.

Le point figurant sur le capuchon de l'aiguille indique l'emplacement du biseau.

2. La gaine peut être tournée dans la position appropriée sur le corps de pompe et reste stable pendant la prise de sang.
3. Sélectionner le site de ponction. Poser le garrot (1 mn max.) et préparer le site de la prise de sang à l'aide d'un antiseptique approprié. Ne pas palper la zone de la prise de sang après l'avoir désinfectée !
4. Mettre le bras du patient en déclive. Retirer le capuchon de l'aiguille. Faites la prise de sang, le bras du patient en déclive et le capuchon du tube vers le haut.
5. Pousser le tube dans le dispositif **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** jusqu'à ce qu'il soit perforé par l'aiguille perce-bouchon. Une perforation excentrée du dispositif **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** peut entraîner une perte de sang et de vide précoces.
6. Desserrer le garrot dès que les premières gouttes de sang arrivent dans le tube. Ne pas laisser le

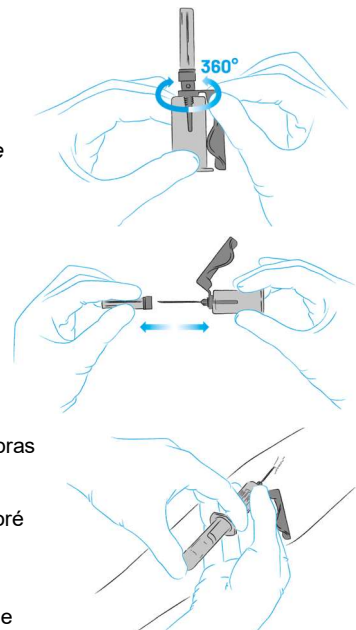

contenu du tube entrer en contact avec le capuchon ou l'extrémité de l'aiguille pendant le prélèvement. En d'autres termes, le tube ne doit jamais être retourné pendant le prélèvement. Maintenir le tube en position à l'aide du pouce, pour maintenir le vide, jusqu'à son remplissage complet.

**REMARQUE :** il est possible que du sang perle de l'aiguille perce-bouchon. Suivre les précautions de sécurité universelles afin de minimiser les risques d'exposition.

- Insérer les tubes dans le corps de pompe les uns après les autres. Veiller à ce que le contenu du tube n'entre pas en contact avec le capuchon ou l'extrémité de l'aiguille pendant le prélèvement sanguin.
- Une fois le dernier tube prélevé, retirer délicatement l'aiguille de la veine, appliquer une pression sur le point de ponction avec une compresse stérile jusqu'à ce que le flux de sang s'arrête. Après la coagulation, appliquer un pansement ou sparadrap stérile si nécessaire.


Ne pas replacer le capuchon sur l'aiguille ! Cela augmente le risque de blessure par piqûre d'aiguille.

**REMARQUE :** après la prise de sang, le creux du bouchon peut contenir des résidus de sang. Prendre les précautions nécessaires pour éviter tout contact avec ce sang lors de la manipulation des tubes.

### Activation de la gaine de sécurité

Immédiatement après avoir retiré l'aiguille de la veine, suivre les procédures suivantes pour activer la gaine de sécurité afin de prévenir les blessures par piqûre d'aiguille.

- Activer la gaine de sécurité en appuyant doucement sur la gaine vers l'aiguille, sur une surface stable. Il est également possible de l'activer en s'aidant du pouce ou d'un autre doigt, qui doit alors toujours rester derrière la gaine. (Voir A1/A2)
- Un clic sonore se fait entendre et indique à l'utilisateur que la gaine de sécurité a été correctement et entièrement activée. Le risque de blessure par piqûre d'aiguille est alors quasiment éliminé. (B)
- Éliminer l'aiguille usagée avec le dispositif **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** dans le conteneur prévu à cet effet. (C)

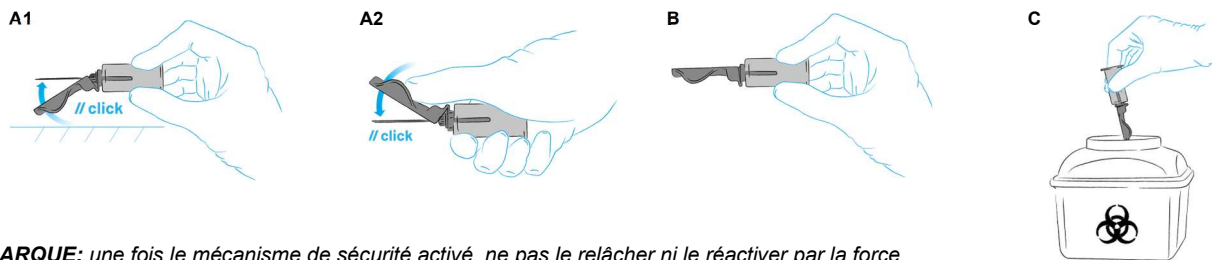

**REMARQUE:** une fois le mécanisme de sécurité activé, ne pas le relâcher ni le réactiver par la force.

### Élimination des déchets

Respecter les recommandations générales en matière d'hygiène et la réglementation applicable à la mise au rebut du matériel infecté. L'utilisation de gants jetables peut éliminer le risque d'infection. Les corps de pompe contaminés doivent être éliminés immédiatement après le prélèvement sanguin dans des conteneurs prévus à cet effet, qui peuvent ensuite être autoclavés puis incinérés.

### Informations sur l'étiquette

	Fabricant	STERILE R	Stérilisé par irradiation		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi
	Date limite d'utilisation		À usage unique		Date de fabrication
	Code de lot		Consulter le mode d'emploi		Dispositif médical
	Référence catalogue		Limite de températures	Rx Only (USA)	Dispositif sur ordonnance
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil		Système de barrière stérile simple		Représentant autorisé en Suisse

Mise en garde : la loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif par ou sur ordre d'un médecin.

Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32  
4550 Kremsmünster  
Autriche

Fabriqué en Autriche

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Téléphone +43 7583 6791

Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH  
St. Leonhardstraße 39  
9000 St. Gallen, Suisse